Algoplaque

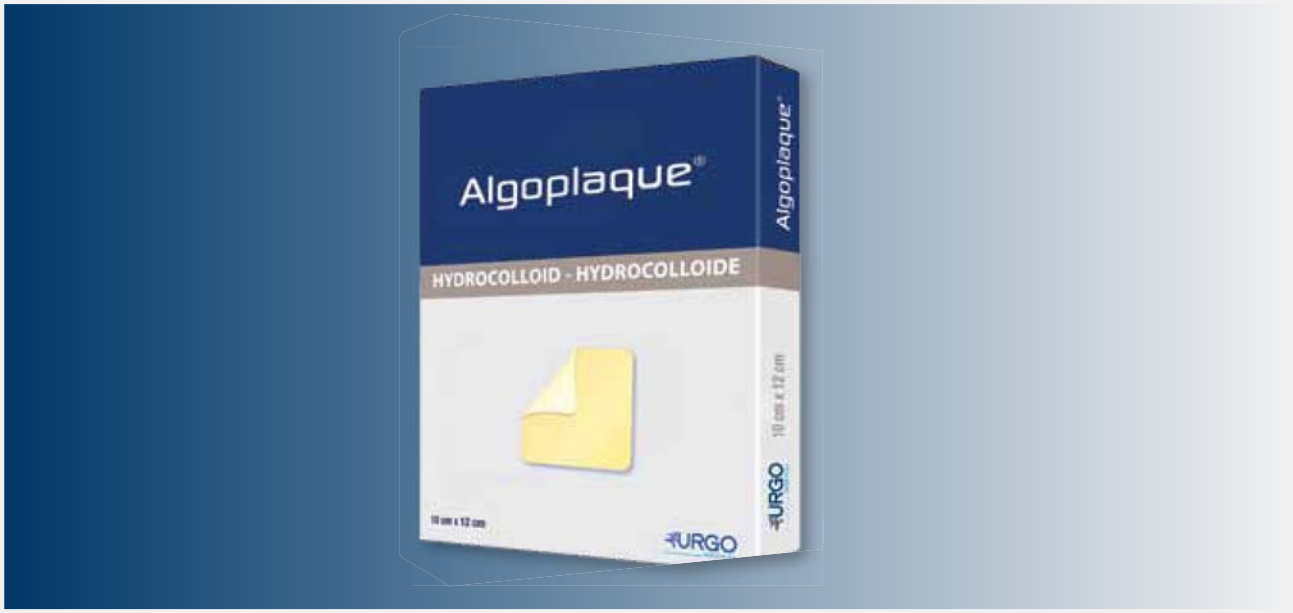

Pansement hydrocolloïde stérile standard

Algoplaque®

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION *Nombre UCD/Boîte*	GROUPAGE *Nombre UCD*	*Nombre boîtes*
502881	Standard : 10 x 10 cm	16	160	10
505845	Moyen : 15 x 15 cm	10	80	8
505843	Grand : 20 x 20 cm	10	80	8

Fabricant : Laboratoires URGO

* Cicatriser avec vous, pour vous

Lire attentivement la notice

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

Algoplaque

DESCRIPTION

COMPOSITION :
- Pansement hydrocolloïde stérile semi-perméable.
  - La couche interne est composée de particules hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose) insérées dans un réseau élastomère.
  - La couche externe, imperméable à l'eau et aux bactéries, est un support semi-perméable en polyuréthane.

PRESENTATION : Conditionnement individuel stérile.
MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- Au contact de la plaie, les particules hydrocolloïdes d'**Algoplaque®** absorbent progressivement les exsudats, gonflent pour former un gel de comblement doux et humide favorable au processus cicatriciel en terme d'hydratation, de température et de pH.
- Ce gel non adhérent évite que le tissu cicatriciel soit endommagé lors des renouvellements de pansements.
- La grande souplesse et l'excellente adhésivité aux pourtours de la plaie permettent à **Algoplaque®** d'épouser les différentes régions anatomiques.
- La transparence de son support permet le contrôle permanent de la formation et de l'aspect du gel.
- Les pansements de la gamme **Algoplaque®** sont perméables à l'air et imperméables à l'eau et aux bactéries. Ces propriétés autorisent la poursuite des bains ou des douches, assurent la protection de la plaie vis-à-vis des contaminations extérieures, et permettent les échanges gazeux, favorisant le drainage des exsudats.
- Stérile.

INDICATIONS

INDICATIONS : Soins locaux des plaies chroniques (ulcères de jambe et escarres) au stade de bourgeonnement.
CONTRE-INDICATION : Ne pas utiliser en cas d'infection.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :
- Préparation de la plaie :
  - Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles.
  - Sécher soigneusement avec une compresse stérile, en particulier sur le pourtour de la plaie.
- Application du pansement :
  - Enlever le film de protection.
  - Appliquer sur la plaie sans tension en évitant de toucher la face adhésive avec les doigts.
  - Lisser le pansement doucement sur la plaie et plus fermement à la périphérie.
- Renouvellement du pansement :
  - Au stade de bourgeonnement, sur une plaie propre, uniformément détergée, **Algoplaque®** sera renouvelé à saturation (tous les 3 à 4 jours en moyenne selon l'importance de l'exsudation).
  - Pour un retrait indolore, effectuer un retrait tangentiel en étirant le support parallèlement à la plaie.
  - Au retrait du pansement, le fond de l'ulcération cutanée peut être recouvert d'un enduit gélatineux qui s'élimine facilement par simple lavage.
  - Dans le cas d'une plaie très fortement exsudative, l'écoulement de substance gélatineuse autour du pansement nécessite son renouvellement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
- L'utilisation d'**Algoplaque®** sur une ulcération d'origine veineuse ne dispense pas du traitement compressif éventuellement prescrit.
- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed).
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

Algoplaque Border
Algoplaque Sacrum

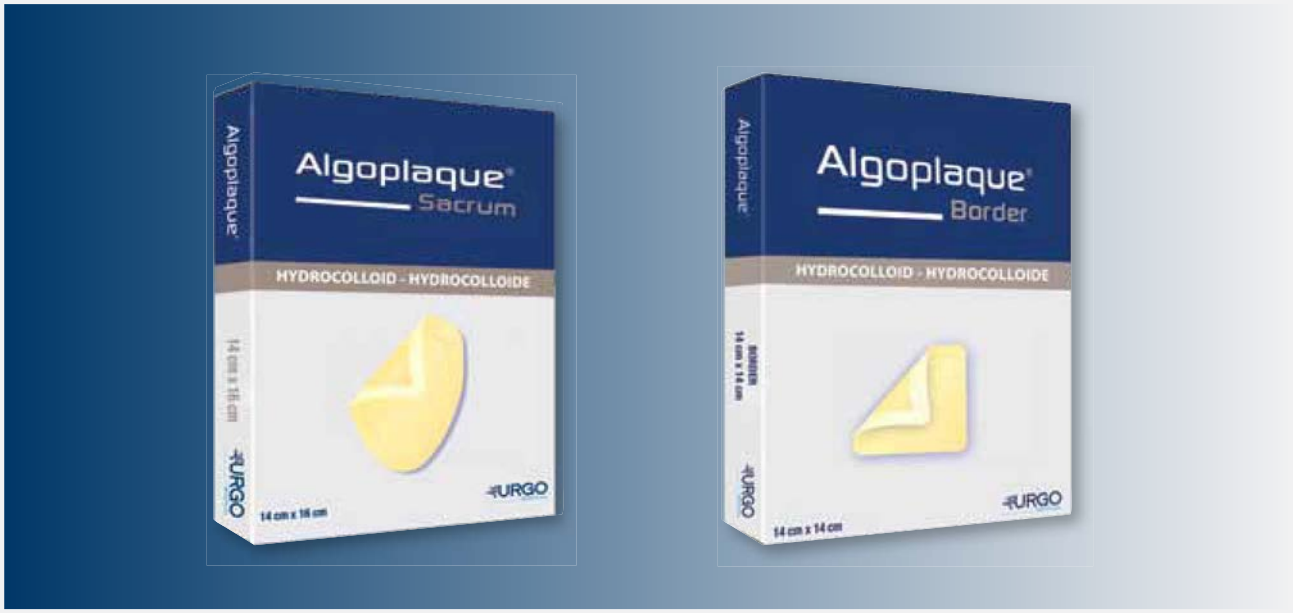

Pansement hydrocolloïde stérile formes anatomiques

Algoplaque® Border

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION *Nombre UCD/Boîte*	GROUPAGE *Nombre UCD*	*boîtes*
502971	14 cm x 14 cm	16	160	10

Algoplaque® Sacrum

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION *Nombre UCD/Boîte*	GROUPAGE *Nombre UCD*	*boîtes*
502973	14 cm x 16 cm	16	160	10

Lire attentivement la notice

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

Algoplaque Border
Algoplaque Sacrum

DESCRIPTION

Algoplaque® Sacrum et **Algoplaque® Border** sont des pansements hydrocolloïdes stériles semi-perméables adaptés à certaines localisations anatomiques de l'escarre et d'adhésivité périphérique renforcée.

COMPOSITION :

- La partie interne centrale du pansement, destinée à venir en contact avec la plaie, est constituée d'hydrocolloïdes naturels appliqués sur un support en polyuréthane semi-perméable.
- La bordure périphérique du pansement, constituée d'un film hydrocolloïde extra-mince, renforce l'adhésivité du pansement autour de la plaie.

PRESENTATION : Conditionnement individuel stérile.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- La forme spécifique d'**Algoplaque® Sacrum** le destine aux escarres de localisation sacrée. Sa bordure périphérique évite les décollements par frottement ou lors d'incontinence associée.
- La grande souplesse et l'adhésivité renforcée d'**Algoplaque® Border** le destine aux plaies de localisations difficiles (escarres trochantériennes, talonnières) soumises à des forces de frottement.
- **Algoplaque® Sacrum** et **Algoplaque® Border** se liquéfient au contact des exsudats de la plaie pour former un gel de comblement doux et humide favorable au processus cicatriciel lors du bourgeonnement et de l'épidermisation de l'escarre. Ce gel non-adhérent évite que le tissu cicatriciel soit endommagé lors des renouvellements de pansements.
- Les pansements de la **gamme Algoplaque®** sont perméables à l'air et imperméables à l'eau et aux bactéries. Ces propriétés autorisent la poursuite des bains ou des douches, assurent la protection de la plaie vis-à-vis des contaminations extérieures, et permettent les échanges gazeux, favorisant le drainage des exsudats.
- Stérile.

INDICATIONS

INDICATIONS : Soins des escarres.

CONTRE-INDICATION **:** Ne pas utiliser en cas d'infection.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Préparation de la plaie :
  - Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles.
  - Sécher soigneusement avec une compresse stérile, en particulier sur le pourtour de la plaie.
- Application du pansement :
  - Oter le film de protection.
  - Appliquer sur la plaie sans tension en évitant de toucher la face adhésive avec les doigts.
  - De par sa forme spécifique, **Algoplaque® Sacrum** s'applique le sommet tourné vers le pli interfessier en essayant d'aplanir le pli pour une meilleure adhésivité immédiate et une protection totale en cas d'incontinence.
  - Lisser le pansement doucement sur la plaie et plus fermement à la périphérie.
  - La bordure adhésive d'**Algoplaque® Sacrum** et d'**Algoplaque® Border** évite de renforcer le pansement lors de l'application.
- Renouvellement du pansement :
  - En fin de détersion des débris fibrino-nécrotiques, **Algoplaque® Sacrum** et **Algoplaque® Border** ramollissent les déchets et accélèrent leur élimination.

A ce stade, le pansement sera renouvelé tous les 1 à 2 jours en moyenne.

- Au stade de bourgeonnement, le pansement **Algoplaque®** sera renouvelé à saturation (tous les 3 à 4 jours en moyenne).
- Au stade d'épidermisation, le pansement sera renouvelé tous les 4 à 6 jours puis progressivement remplacé par **Algoplaque® Film**.

Pour un retrait indolore, effectuer un retrait tangentiel en étirant le support parallèlement à la plaie.

Au retrait du pansement, le fond de l'ulcération cutanée peut être recouvert d'un enduit gélatineux qui s'élimine facilement par simple lavage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed).

Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*